

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โคมไฟผ่าตัดในญี่โคมคุ่นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลัคซ์ หลอดแอลอีดี
โรงพยาบาลชีรากูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต**

๑. ความเป็นมา โรงพยาบาลชีรากูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดในญี่โคมคุ่นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลัคซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน ๔ ชุด ด้วยเงินจากโครงการสลากรกรุงศรี โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย)

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับงานผ่าตัดทุกศัลยกรรม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประการราคาซึ่งด้วยวิธีการประกราคากลางๆ หรืออเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดภูเก็ต ณ วันประกาศประกราคากลางๆ อเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกราคากลางๆ อเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลักษณ์ความคุ้มกัน เช่นว่า

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมค้าไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(ลงชื่อ).....*ก.*.....ประธานกรรมการ
 (นายชานินทร์ บุญตั้งใจ)
 (ลงชื่อ).....*ก.*.....กรรมการ (ลงชื่อ).....*ก.*.....กรรมการ
 (นายศุภชัย พันธ์พิเชฐ) (นางพัชรี ประทีปไปศาลกุล)

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้อง มีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มี การตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒)กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓)สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงิน ฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอใน แต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงิน ฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔)กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัติตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทறานโดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบ อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕)กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

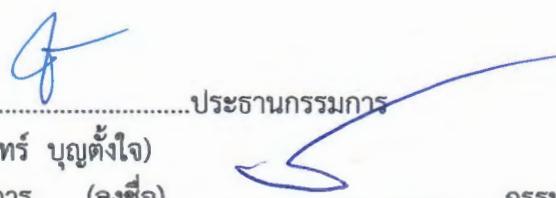
(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป (ต่อชุด)

๔.๑.๑ เป็นคอมไฟผ่าตัดชนิดติดเพดาน แบบคอมคู่ชนิดแ甘ร่วม แบบไฟ LED หลายดวงในแต่ละคอม สามารถหมุนปรับระดับได้อย่างอิสระ


 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ) นางสาวนันทร์ บุญตั้งใจ)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายศุภชัย พันธ์พิเชฐ) (นางพัชรี ประทีปไพบูลย์)

๔.๑.๒ ตัวคอมออกแบบ เพื่อทำให้อากาศเหนือคอมหมุนเวียนได้ดีโดยเมื่ออากาศสะอาดไหลลงมากระหบคอมไฟผ่าตัดเพื่อให้สอดคล้องกับ Laminar Air Flow ทำให้อากาศสะอาดสามารถไหลลงสู่บริเวณผ่าตัดเพื่อลดการติดเชื้อ และตัวคอมสามารถเข้าดัดทำความสะอาดง่าย

๔.๑.๓ มีระบบ Synchronization เพื่อความคุ้มความสว่าง อุณหภูมิสี ของทั้ง ๒ โคมพร้อมกัน หรือมีระบบเทียบเท่า

๔.๑.๔ สามารถติดตั้งกล้องบันทึกภาพความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า Full HD ภายหลัง

๔.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๒.๑ ความเข้มการส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า ๑๖๐,๐๐๐ ลักซ์ ($\pm 10\%$) (ที่ระยะส่องสว่าง ๑ เมตร)

๔.๒.๒ ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสง ได้ขนาดช่วงแคบสุดไม่น่ากว่า ๑๕ เซนติเมตร ถึงกว้างสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร

๔.๒.๓ อุณหภูมิสี (Color temperature) สามารถปรับได้ในช่วงไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ถึง ๕,๑๐๐ Kelvin และปรับได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ

๔.๒.๔ มีค่าดัชนีความถูกต้องของสี (Color rendering index CRI, Ra และ R_a) ไม่น้อยกว่า ๘๕

๔.๒.๕ มีด้านจับสามารถปรับให้อยู่ในท่าต่าง ๆ ได้ สามารถถอดออกเพื่อนำเข้าเชื้อได้

๔.๒.๖ หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๔.๒.๗ มีด้านจับสำหรับปรับคอมไฟให้อยู่ในท่าทางและระดับต่างๆ ที่สามารถถอดออกเพื่อนำเข้าเครื่องได้

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๓.๑ เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑KVA

จำนวน ๑ เครื่อง/๑ ชุด

๔.๓.๒ ด้ามจับคอมไฟชนิดถอดฆ่าเชื้อได้

จำนวน ๖ ชิ้น/๑ ชุด

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ มีหลักฐานการนำเข้าและการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ออกโดยองค์กรอาหารและยาประเทศไทย ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๔.๒ มีช่างบำรุงรักษา ซ่อมแซม ที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิตและมีใบรับรองการผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ คน ยื่นในวันเสนอราคา

๔.๔.๓ บริษัทผู้จำหน่าย จะต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และอบรมการซ่อม/บำรุงรักษา/การสอบเทียบ ให้แก่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๔.๔.๔ มีการบำรุงรักษาตรวจสอบทุก ๓ เดือน ในระยะรับประกัน พร้อมจัดส่งรายงานให้แผนกที่ใช้เครื่องมือและศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลควบคุมภัยเงียบ

๔.๔.๕ มีการสอบเทียบเครื่องมือปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุรับประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น




๔.๔.๖ โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล CE หรือ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่าย

๔.๔.๘ บริษัทผู้ขายและบริษัทผู้ให้บริการดูแลหลังการขายต้องเป็นบริษัทเดียวกัน

๔.๔.๙ บริษัทผู้ขายและบริษัทผู้ให้บริการดูแลหลังการขายต้องเป็นบริษัทเดียวกัน

๔.๔.๑๐ บริษัทผู้ขายจะต้องแสดงรายละเอียดและลงนามเลขที่ในแคดตราล็อคให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางราชการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายศุภชัย พันธ์พิเชฐ)
 (นางพัชรี ประทีปไพบูลกุล)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

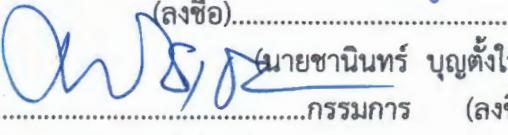
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดนำหน้าการให้คะแนน รวมร้อยละ ๑๐๐ แบ่งออกเป็น

๖.๑ ราคาก่อสร้าง ร้อยละ ๒๐

๖.๒ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ร้อยละ ๘๐

โดยเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	สามารถปรับระดับความสว่างได้ ๑๐ ระดับ และขนาดของวงแสง ๑๐ ระดับ เพื่อให้ได้ลำแสงที่ตรงตามความต้องการใช้งาน - ปรับได้ ๑๐ ระดับทั้ง ๒ พิพิธน์ - ปรับได้ ๑๐ ระดับ อย่างใดอย่างหนึ่ง - ปรับได้ไม่ถึง ๑๐ ระดับ	๒๐	
๒	มีระบบตรวจจับวัตถุที่มาบดบังแสงและมีเทคโนโลยีที่ช่วยซัดเชยแสง อัตโนมัติเมื่อมีวัตถุมาบดบัง ให้ลำแสงมีคุณภาพและมีความสว่างคงที่ โดยสามารถเลือกเปิด หรือปิดการทำงานได้ - มีระบบตรวจจับวัตถุที่มาบดบังแสง และมีเทคโนโลยีชัดเชย แสงอัตโนมัติ เลือกเปิด/ปิด การทำงานได้ - มีระบบตรวจจับวัตถุที่มาบดบังแสง และมีเทคโนโลยีชัดเชย แสงอัตโนมัติ ไม่สามารถเลือกเปิด/ปิด การทำงานได้ - ไม่มี	๒๐	
๓	สามารถเลือกโหมดการทำงานเฉพาะทาง สำหรับการผ่าตัดสาขา งานต่างๆ ได้ - มีโหมดสำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง และโหมดอื่นๆ รวมเลือกได้ ๖ โหมดหรือมากกว่า - มีโหมดสำหรับการผ่าตัดแบบส่องกล้อง และโหมดอื่นๆ รวมน้อยกว่า ๖ โหมด - ไม่มี	๒๐	
๔	Constant focal depth (L๑+L๒)(๒๐% Ec) - ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม - ในช่วง ๑๒๐ - ๑๓๙ ซม - น้อยกว่า ๑๒๐ ซม	๑๐	
		๑๐	
		๕	
		๐	

(ลงชื่อ).....

 นายพานิธ บุญตั้งใจ
 (ลงชื่อ).....
 กรรมการ (ลงชื่อ).....
 (นายศุภชัย พันธ์พิเชฐ)
 (ลงชื่อ).....
 กรรมการ (ลงชื่อ).....
 (นางพัชรี ประทีปไพบูลกุล)

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕	มีพังชั่นที่ช่วยลดความต่างของแสงภายในบริเวณพื้นที่ผ่าตัดและบริเวณรอบๆ โดยสามารถเปิดหรือปิดการทำงานได้ เพื่อความสบายตาของผู้ใช้ - มีพังชั่นค์ และเลือกเปิด/ปิด การทำงานได้ - มีพังชั่นค์ แต่ไม่สามารถเลือกเปิด/ปิด การทำงานได้ - ไม่มี	๑๐	
๖	ด้านจับสามารถปรับพังชั่นค์ ได้อย่างน้อย ๓ พังชั่นค์ เช่น ความสว่าง, ขนาดของลำแสง และอุณหภูมิสี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน - ทำได้ อย่างน้อย ๓ พังชั่นค์ - ทำได้ ๑ - ๒ พังชั่นค์ - ทำไม่ได้	๑๐	
๗	มีไฟส่องสว่างในรูปแบบการผ่าตัดผ่านกล้องโดยเฉพาะ แยกจากหลอดไฟหลัก - มีพังชั่นค์ - ไม่มีพังชั่นค์	๑๐	
		๑๐๐	

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ด้วยเงินจากโครงการสลากรากุศล โครงการพัฒนาศักยภาพการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ (เหลือจ่าย) วงเงินงบประมาณ ๕๕๕๖๖.๖๔ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทมีห้าสิบหกกรัมหกสิบบาทหกสิบสี่สตางค์)

๘. งานด่วนและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ให้ครบถ้วน และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจัดซื้อ โรงพยาบาล วชิรภูเก็ตจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๖๐ ต่อวัน ของราคารสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบนับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ซื้อขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๓ ปี นับถ้วนจากวันรับมอบสินค้าครบเป็นต้นไป ในระยะรับประกัน หากเกิดข้อห้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไข ๓ ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๓๐ วัน


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... นายธนาธิร บุญตั้งใจ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายศุภชัย พันธ์พิเชฐ) (นางพัชรี ประทีปไพศาลกุล)